



1.15
メンテナンスと
EMF

標準取扱説明時間 : 0:10:00
ビデオ概算時間 : 0:06:00

[ビデオを再生する](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
66



メンテナンス

- [ダッシュボード] ペインの各アイコンをクリック
- メンテナンスメニューからそれぞれのメンテナンスを実行可能


 Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
67

メンテナンス

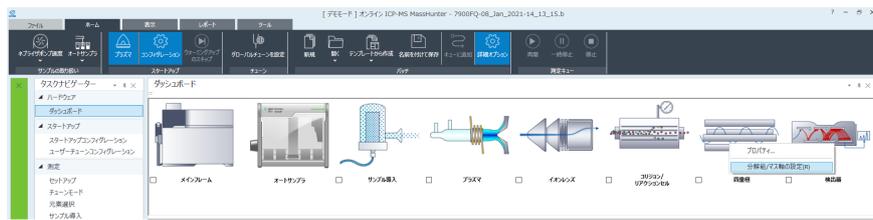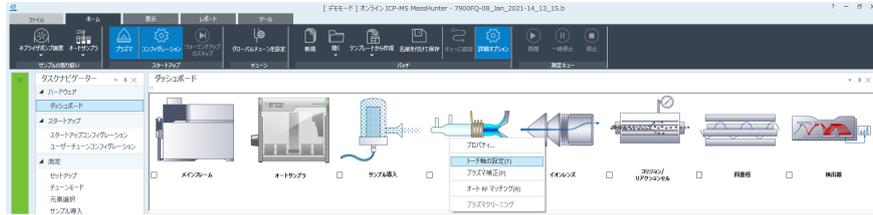

EMF

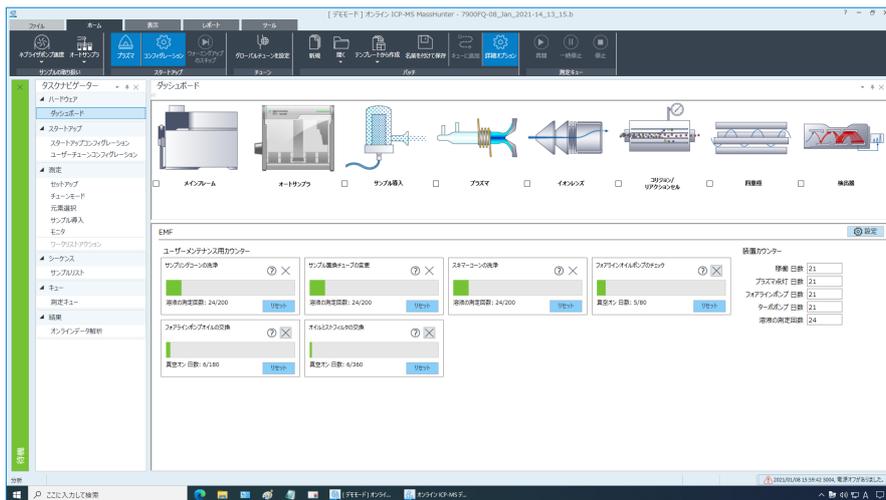

EMFの設定

