




1.3 プラズマ点火と スタートアップ

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:07:00

[ビデオを再生する](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
13

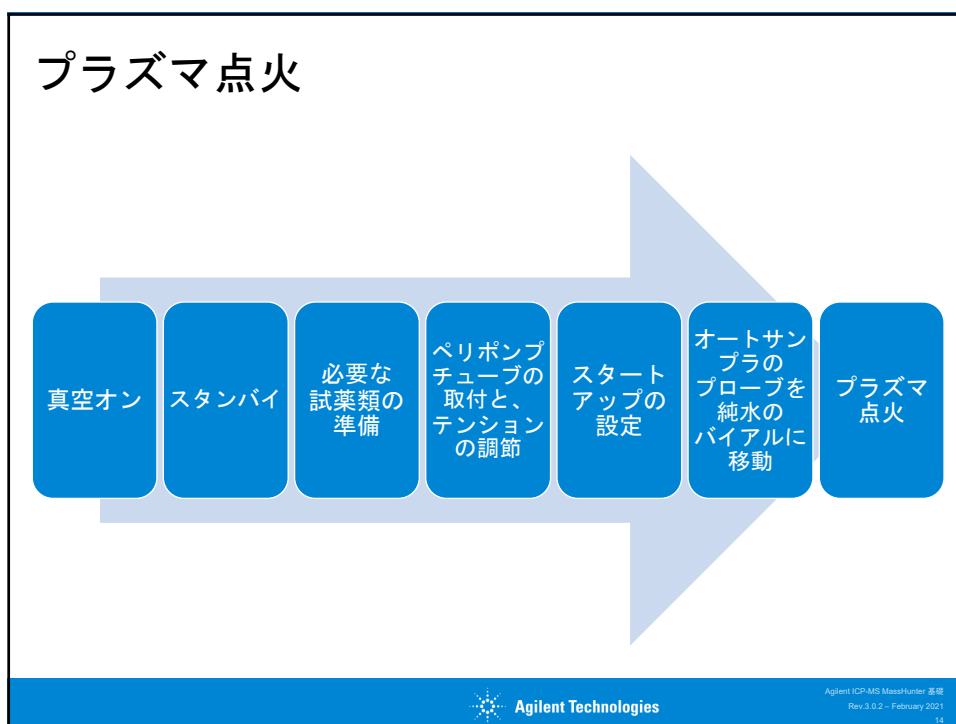

その他

- [ステータス ビューア]
- [ウォーミングアップのスキップ]
- [最後にプラズマオフ]
- プラズマが既に点火している状態でのスタートアップの実行
- [点火シーケンスの設定]