




1.3 等离子体点火 和启动

标准操作说明时间: 0:10:00
视频估算时间: 0:07:00

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
13

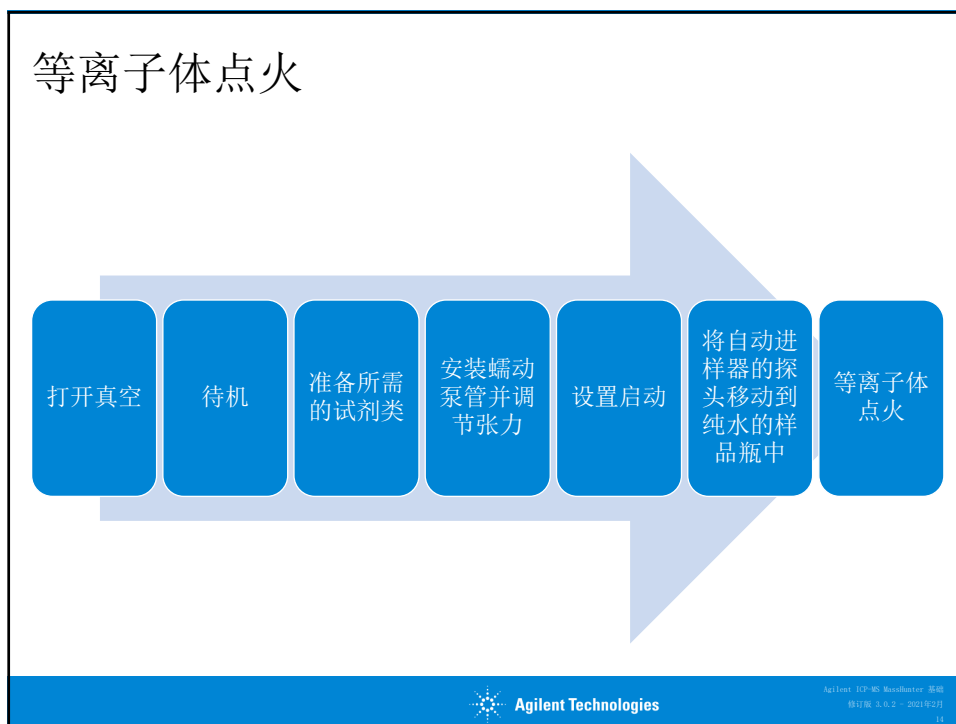

其他

- [状态查看器]
- [退出预热]
- [最后关闭等离子体]
- 在等离子体已处于点火状态下执行启动
- [配置点火序列]